




ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



Проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF-SO5-NO1-A22, съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“
Дейност 1 „Доставяне на ново техническо оборудване за откриване, фиксиране, изземване и лабораторен анализ на веществени доказателства“

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 5785опм-30-5785мпд- 14.....22.....04.2019 г.

Днес,2019 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785мпр-78 от 14.12.2018 г. на директора на „Научноизследователски институт по криминалистика“ - МВР в качеството на оправомощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП се сключи настоящият договор, между:

1. **МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „6-ти септември“ № 29, БУЛСТАТ 000695235, ИН по ДДС: BG 000 695 235, представлявано от Добринка Маркова – Директор НИК-МВР, оправомощена със заповед рег. № 81213-1235/04.10.2018 г. на министъра на вътрешните работи, от една страна, наричано по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**,

и

2. **„Лабтех“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: Пловдив, ул. „Иван Андонов“ № 13, ЕИК (БУЛСТАТ) 115752045, представлявано от Стамен Стоянов, действащ в качеството си на Управител, от друга страна, наричано по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, се сключи настоящия договор с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника“, **обособена позиция № 2 „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“**, по проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF-SO5-NO1-A22, съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши по обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника“, **обособена позиция № 2 „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“**: доставка и пускане в експлоатация на лабораторна хладилна техника по видове и количества и в съответствие с Техническата спецификация – Приложение № 1 и Техническото предложение – Приложение № 2, неразделна част от договора.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ 1
BG/ISF-SO5-NO1-A22, съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“
Дейност 1 „Доставяне на ново техническо оборудване за откриване, фиксиране, изземване и лабораторен анализ на веществени доказателства“



ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



Чл. 2. Срокът за изпълнение на дейностите по чл. 1 е **90 дни** от влизане в сила на договора.

Чл. 3. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Чл. 4. (1) Мястото за изпълнение на доставката и извършване на дейностите, свързани с нея е : НИК-МВР, гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1.

(2) Достъпът на представител/-и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта по ал. 1 се осигурява при стриктно спазване на правилата за достъп в обекти на Министерството на вътрешните работи и в съответствие с Инstrukция № 8121з-1415 от 20 ноември 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ. бр. 93 от 1 декември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 36 от 27 април 2018 г.).

III. КАЧЕСТВО

Чл.5. (1) Качеството на доставката следва да отговаря на техническите характеристики от Техническото предложение – Приложение № 2 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация – Приложение № 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че техниката, предмет на доставката, е неупотребявана и от модели, които са в производствената листа на производителя.

(3) Доставката следва да е придружена с Техническа документация, съдържаща Техническо описание; инструкция/ръководство за ползване.

IV. ЦЕНА

Чл. 6. (1) Общата стойност на договора е в размер на 11 999,00 (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева без ДДС, съответно 14 398,80 лева (четиринадесет хиляди триста деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки) с ДДС, съгласно ценовото предложение – Приложение № 3, неразделна част от договора.

(2) Всички цени от Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора, включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и не подлежат на промяна.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. Плащането се извършва по банков път в рамките на 30 (тридесет) дни, след представяне на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол за приета доставка и подписване на констативен протокол за проведени тестове и въвеждане в експлоатация на хладилната техника, съгласно чл. 20, ал. 1 и оригинална фактура.

Чл. 8. (1) Плащането се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



IBAN: BG45RZBB91551085307915

BIC: RZBBBGSF

БАНКА. Райфайзен Банк Пловдив

(2) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението на настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по проект **BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания”** – съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност”.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранно подписан констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговорената цена при изпълнение на поръчка в размера и при условията на този договор.
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнената поръчка.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.


Чл.11. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни насрещното си задължение по договора.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;
2. да осъществи доставка и да въведе в експлоатация техниката, съгласно приложените към договора Техническа спецификация, ценово предложение и техническото предложение на мястото посочено в чл. 4;
3. да изпълни доставката, пълно, точно, качествено, в срока, определен по този договор и при спазване на действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми;
4. да отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени дефекти в процеса на изпълнението на договора и в гаранционния срок;
5. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността и риска върху техниката при доставянето ѝ след подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;
6. да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на текущ контрол и да предоставя информация за хода на изпълнението;
7. да организира транспортирането, разтоварването, тестването и пускането в експлоатация на доставката за своя сметка;



ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



8. да предоставя гаранционно обслужване при условията на този договор;

9. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди, или да не разгласява пред трети лица каквито и да било данни и информация, станали му известни при или по повод изпълнението на настоящия договор, за цели, които не са свързани с предмета на този Договор, или която информация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана, освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си;

10. да съдейства на националните или други компетентни органи съгласно грантовото споразумение

https://www.mvr.bg/dmp/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-2014-2020-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%822014-2020-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8/ISF_SO5_NO1_A22


при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор;

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставената доставка (лого на програмата с информация за източника на финансиране);

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

13. при изпълнение поръчката да спазва всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на грантовото споразумение

https://www.mvr.bg/dmp/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-2014-2020-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%822014-2020-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8/ISF_SO5_NO1_A22



%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8/ISF_SO5 NO1_A22

14. Да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на дейностите по договора, да отстранява недостатъци и пропуски и да извършва необходимите поправки за своя сметка;

15. Да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни в срок и без отклонения съответните дейности, съгласно Техническото предложение.

2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. да претендира отстраняването на отклонения и недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. да откаже да приеме доставената техника, ако открие недостатъци в нея или несъответствия между нея и изискванията на този договор.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

2. да приеме доставената техника, която отговаря на изискванията посочени в чл. 5, ал. 1;

3. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на договора;

4. да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническата информация и съдействие, които са поискани във връзка с изпълнението на дейностите по договора.


VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 15. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС или 599,95 лева (петстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и пет стотинки).

(2) 50 % (петдесет) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 16.



ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, следва да бъде преведена по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG09 BNBG 9661 3300 1462 01, BIC Code: BNBGBGSD, БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, адрес пл. „Княз Александър I“ № 1, на името на Министерство на вътрешните работи.

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност – срока на изпълнение на договора, плюс гаранционния срок по чл. 16, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност срока на изпълнение на договора, плюс гаранционния срок по чл. 16, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.


(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Когато договорът е прекратен преди неговото изпълнение, гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след неговото прекратяване, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(9) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът ѝ, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнението му и със срок на валидност срока за изпълнение на договора, плюс гаранционният срок по чл. 16, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност срока на изпълнение на договора, плюс гаранционния срок по чл. 16, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер. Условиата на застраховката се съгласуват с Възложителя.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.



(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

(13) Гаранцията за изпълнение се освобождава, както следва:

1. 50% (петдесет на сто) в срок от 30 (тридесет дни) след подписване на предавателно-приемателен протокол за приета доставка по чл. 20, ал. 1.

2. 50% (петдесет на сто) в срок от 30 (тридесет дни) след изтичане на гаранционния срок по чл. 16, ал. 1 и подписване на протокол по чл. 20, ал. 9, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл. 16. (1) Гаранционният срок на доставката е 36 (тридесет и шест) месеца, като започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 20 ал. 1.

(2) Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17 (1). При поява на дефекти или технически проблеми в гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме действия по: установяване на проблема с доставената техника и да възстанови нормалната работоспособност на дефектиралата техника в срок, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира и осигурява транспорта от клиента до сервиза и обратно, като поема изцяло разходите за тези дейности.

(3) Ремонтът по възможност се извършва на място в обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, товаро - разтоварните дейности и транспортът на техниката до сервиза и обратно са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото устройство с ново със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. Срокът за това е съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури надеждно обслужване и поддръжка на доставената техника в гаранционния срок и в съответствие с изискванията на техническата спецификация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури контактна точка за подаване на заявки за сервизна услуга (ЗСУ). Достъпът до нея трябва да е осигурен чрез телефонен номер, факс и e-mail в Р. България и не трябва да поставя потребителите пред нуждата да плащат разговори по международни тарифи или за телефони с добавена стойност.



(3) Контактната точка за подаване на ЗСУ е: 032 268627, факс. 032 242410, e-mail: labtech@mbox.contact.bg;

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури обслужване в рамките на работното време 8:30 до 17:00 в работни дни на всички постъпили ЗСУ.

(5) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подава ЗСУ, като съобщава серийния номер на повредената техника и идентифицираните последствия от повредата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката.

Чл.19 (1) Ремонтът се извършва с нови резервни части, модули и възли. Протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ) изготвя сервизният специалист от Изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ. В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни - по един представител за всяка страна. Ремонтът трябва да се извърши за не повече от 20 (двадесет) работни дни от подаване на ЗСУ.

(2) В случай на използване на нови съвместими резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да гарантира, че няма да се наруши работоспособността на системата.

Х. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО


Чл.20.(1) Приемането на дейностите по чл. 1 се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 4. Приемане изпълнението на дейностите по договора се удостоверява, с двустранно подписан предавателно - приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предавателно - приемателният протокол се подписва след подписване на констативен протокол за проведени тестове и въвеждане в експлоатация на хладилната техника.

(2) След получаване на доставката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да я прегледа и ако констатира недостатъци или несъответствие с договореното, с техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят двустранен констативен протокол за констатирани недостатъци/ несъответствия.

(3) След съставянето на двустранния констативен протокол по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да подмени техниката, за която има рекламация, и/или да отстрани констатираните недостатъци в съответствие с техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото си предложение за своя сметка.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съвместно с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ провеждат приемателни тестове на доставената техника, за което се подписва протокол между представители на страните по договора.

(5) В случай че не са открити недостатъци и/или несъответствия на доставката или други дейности, или същите бъдат отстранени по реда на ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписват предавателно - приемателни протоколи за тази част на доставката или дейностите по договора.



(6) Приемането на изпълнението на доставката по реда на ал. 1 не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за скрити недостатъци на доставената техника, които не са могли да бъдат установени по реда на ал. 2. Рекламации относно скрити недостатъци се правят в седемдневен срок от откриването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок по чл.16, ал. 1.

(7) Страните определят оторизирани лица по договора, които да подписват предавателно приемателните и констативните протоколи.

(8) Собствеността и рискът от случайно погиване на доставката преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписването на предавателно приемателния протокол за приемане на доставката по ал. 5.

(9) След изтичането на срока по член 16, ал. 1 страните подписват протокол, удостоверяващ изпълнението на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на гаранционния срок.

XI. НЕУСТОЙКИ

Чл. 21. При забава на изпълнение на задължение по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05 % на сто от общата стойност с ДДС по чл. 6, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) общо.

Чл. 22. При лошо изпълнение на свое задължение по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността с ДДС на некачествените стоки.

Чл. 23. При частично неизпълнение на свое задължение по договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността с ДДС на неизпълнената част.

Чл. 24. Ако е в забава за плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 20 (двадесет) на сто от общата стойност с ДДС по чл. 6, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.


Чл.26 (1) При прекратяване на договора по чл.31, ал. 2, т.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата стойност с ДДС по чл. 6, ал. 1.

(3) При констатиране от компетентен орган нередности от действия или бездействия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата до размера на нередността.

Чл.27 При прекратяване на договора по чл. 31, ал. 2, т. 1 страните не си дължат неустойки.

Чл. 28. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни,



считано от датата на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.

Чл. 29. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този договор.

ХII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

Чл. 31. (1) Настоящият договор се прекратява с неговото изпълнение и след изтичане на гаранционния срок.

(2) Договорът може да бъде прекратен предсрочно в следните случаи:

1. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма, с което се уреждат и финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие при виновно неизпълнение на задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената и приета доставка, ако към момента на уведомлението доставката вече е извършена и приета.

4. При констатиране нередности по смисъла на европейското законодателство и/или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

6. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;


7. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 15, ал. 5, изречение второ или ал. 9, изречение второ, от този договор.

8. при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно без предизвестие да прекрати действието на договора, когато:



ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши част или цялата доставка по чл. 1 в срока, договорен между страните или не отстрани в договорените в този договор срокове констатирани недостатъци;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на доставката с повече от 10 /десет/ дни, считано от деня следващ датата на изтичане на уговорения срок.

(4) В случаите на ал. 2 и ал. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения, неустойки и/или пропуснати ползи.

Чл. 32. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират конфиденциалност при използването на предоставените документи, материали и информация по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за това.

XIV. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава всички информационни материали при доставка да включват в тях:

- Наименованието на проекта: „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания” BG/ISF – SO5-NO1-A22 – съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност”
- Флаг на Европейския съюз и Република България
- Пояснение: Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за вътрешна сигурност на Европейския съюз.

XV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 37. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и



непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

XVI. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ПРОВЕРКИ И ОДИТ

Чл. 38. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и предоставя всяка изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, националните и европейските компетентни органи, както и от други лица и органи имащи право на проверка или одит, информация относно изпълнението на този договор до 4 години след отчитане на окончателното плащане от Отговорния орган по договора за БФП пред Европейската комисия.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че националните компетентни органи и европейските компетентни органи могат да извършват одит директно чрез свои служители или оторизирани лица. Този одит може да бъде извършван през периода на изпълнение на договора, до извършване на окончателното плащане и след това/по всяко време. Когато е намерено за



подходящо, констатациите от одита могат да доведат до възстановяване на суми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на служители на националните компетентни органи, на европейските компетентни органи или оторизирани от тях лица до сгради и помещения, където са се провеждали дейности по договора, както и до цялата информация, включително и на електронен носител, необходима за извършване на одит.

ХVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. (1) Страните по този договор могат да го допълват и изменят само в предвидените от закона случаи, по взаимно съгласие, изразено писмено.

(2) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.

Чл. 40. (1) Всички заявки, съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на договора са валидни, ако са направени в писмена форма на български език и са връчени лично срещу подпис, изпратени с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс. Изпратените по факс материали се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с настоящия договор се смятат:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Директор на НИК-МВР, гр. София, бул. „Ал. Малинов“ № 1, тел. + 359 2 982 90 06, факс + 359 2 982 91 21;

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Стамен Георгиев Стоянов, управител; тел: 032 268627 факс: 032 242410;

Чл. 41. (1) При промяна на посочени адреси, телефони и други координати и данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

(2) Ако страната по договора не изпълни задължението си по ал. 1 се счита, че съобщенията са връчени редовно.

Чл. 42. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 43. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 44. Неразделна част от този договор са:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация – 2 стр.



ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



2. Приложение № 2 - Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка – 15 стр.;

3. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено в процедурата за възлагане на обществена поръчка - 1 стр.;

Чл. 45. За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в три еднакви оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. (подпис и печат) ДИРЕКТОР НА НИКОВР ДОБРИНКА МАРКОВА (оправомощено лице, съгласно заповед рег. № 81213-1235/04.10.2018 г. на министъра на вътрешните работи) Дата на подписване: 2. <i>Добринка Маркова</i> (подпис) Лице, отговорно за счетоводните записвания: Дата на подписване:	 (подпис и печат) СТАМЕН СТОЯНОВ Дата на подписване:

Обособена позиция № II – „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“

№	Показател	Изисквана стойност
II.1.1	Полезен обем на фризер	Минимум 250л
II.1.2	Температурен диапазон	-50°C ÷ -80°C или по-широк
II.1.3	Охладителна система	поне два компресора
II.1.4	Начин на размразяване	Автоматично или ръчно
II.1.5	Материал	Стомана или еквивалент
II.1.6	Температурен контрол	Дигитален панел с резолюция поне 0.1°C, показващ работна и зададена температура.
II.1.7	Алармена система при неизправност, спиране на захранването и отворена врата	Звукова и светлинна алармена система Автономно захранване на алармената система с батерия
II.1.8	Рафтове	Стоманени (или еквивалентни) с минимум три броя рафтове и вътрешни врати
II.1.9	Работа при околна температура	+15°C ÷ +25°C или по широк
II.1.10	Ел. захранване	220-240V

1. Общи технически и екологични изисквания към лабораторната хладилна техника, описана в таблицата по-горе:

1.1. Доставената хладилна техника следва да е нова, неупотребявана и от модели, които да са в производствената листа на производителя.

1.2. При доставка Изпълнителят да предостави комплект на техническа документация на хартия за доставяната лабораторна хладилна техника. Техническата документация трябва да съдържа: Техническо описание; инструкция/ръководство за ползване. В офертата си участникът декларира, че ако бъде избран за изпълнителя, доставката ще бъде придружена с документите по тази точка.

1.3. Ниво на шум на доставената лабораторна хладилна техника до: 58 dB (A).

1.4. Участниците да посочат „Потенциал за разрушаване на озоновия слой (ODP)“ на предлаганата техника.

1.5. Всички предлагани уреди да имат CE-маркировка или декларация за съответствие съгласно ЕС норми.

1.6. Участниците да разполагат със сервиз за осигуряване на гаранционното обслужване на лабораторна хладилна техника. Подава се декларация за сервиза/сервизите, който/които ще бъде/ат използвана/-и за изпълнение на поръчката, в която се посочват сервиза/сервизите, неговият/техните адрес/и, телефони за връзка, факс и/или електронна поща, лица за контакт.

	ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“	
---	---------------------------	---

2. Общи изисквания относно дейностите по гаранцията:

- 2.1. Гаранционен срок да бъде не по-малък от 36 месеца считано от датата на приемателно-предавателен протокол за въвеждане на техниката в експлоатация.
- 2.2. Изпълнителят е длъжен да осигури обслужване и поддръжка в рамките на гаранционния срок. За решаване на възникнали технически проблеми Изпълнителят поема задължението да предостави контакти (име, телефонен номер, факс и e-mail) на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България.
- 2.3. В рамките на гаранционния срок изпълнителят отстранява всички повреди до 20 /двадесет/ работни дни от уведомяването му.
- 2.4. Ремонтът да се извършва с нови оригинални или нови съвместими резервни части по възможност на място в обекта на Възложителя, за което сервизният специалист изготвя протокол за извършена сервизна услуга.
- 2.5. В случай на използване на нови, съвместими, резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да гарантира, че няма да се наруши нормалната работоспособност на системата.
- 2.6. В рамките на гаранционния срок да са включени всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт на хладилната техника.

*Пособените в настоящата техническа спецификация показатели и параметри са минимално изискуеми.

Изготвили техническата спецификация:

1.

Заличена информация на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

(Цв. Нишев)

2.


Заличена информация на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

(О. Иорданова)

3.

Заличена информация на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

(В. Пинова)



ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


от: Лабтех ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника“, обособена позиция № 2 – „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Техническата спецификация.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗИСКАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ		ПРЕДЛОЖЕНО ОТ УЧАСТНИКА
Вертикален нискотемпературен фризер с минимален обем 250 л. – 1 (една) брой		Модел ZEN LT 300 COME
		Производител POL-EKO
		APARATURA – Полша
Показател	Изисквана стойност	Предложена стойност за съответния показател
Полезен обем на фризер	Минимум 250 л.	326 л.
Температурен диапазон	-50°C ÷ -80°C или по-широк	-40°C ÷ -86°C
Охладителна система	поне два компресора	два компресора
Начин на размразяване	Автоматично или ръчно	Ръчно
Материал	Стомана или еквивалент	Неръждаема стомана DIN1.4016
Температурен контрол	Дигитален панел с резолюция поне 0.1°C, показващ работна и зададена температура.	Дигитален панел с резолюция поне 0.1°C, показващ работна и зададена температура.
Алармена система при неизправност, спиране на захранването и отворена врата	Звукова и светлинна алармена система Автономно захранване на алармената система с батерия	Звукова и светлинна алармена система Автономно захранване на алармената система с батерия
Рафтове	Стоманени (или еквивалентни) с минимум три броя рафтове и вътрешни врати	Четири камери от неръждаема стомана DIN1.4016 с 4 отделни вътрешни врати и 4 броя рафтове
Работа при околна температура	+15°C ÷ +25°C или по широк	+15°C ÷ +28°C
Ел. захранване	220-240V	220-240V

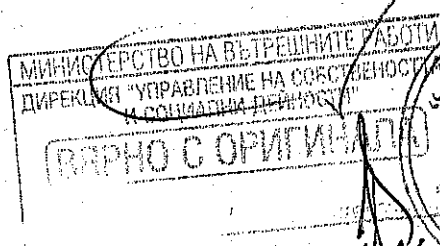

II. Общи технически и екологични изисквания към лабораторната хладилна техника, описана в таблицата по-горе:

1. Декларирам, че:

Доставената хладилна техника ще е нова, неупотребявана и от модели, които са в производствената листа на производителя.

2. При доставка ще предоставим комплект на техническа документация на хартия за доставяната лабораторна хладилна техника. Техническата документация ще съдържа: Техническо описание; инструкция/ръководство за ползване. Декларирам, че ако бъде избран за изпълнител, доставката ще бъде придружена с документите по тази точка.

3. Ниво на шум на доставената лабораторна хладилна техника до 58 dB /A/;

4. „Потенциал за разрушаване на озоновия слой /ODP/“ на предлаганата техника 0;

5. Всички предлагани уреди ще имат CE-маркировка или декларация за съответствие съгласно ЕС норми.

6. Разполагаме / не разполагаме (излишното се зачертава от участника) със сервиз за осигуряване на гаранционното обслужване на лабораторна хладилна техника.

6.1. Подаваме декларация за сервиза/сервизите, който/които ще бъде/-ат използвана/-и за изпълнение на поръчката, в която се посочват сервиза/сервизите, неговият/техните адрес/и, телефони за връзка, факс и/или електронна поща, лица за контакт.

III. Общи изисквания относно дейностите по гаранцията:


1. Предлагаме гаранционен срок от 36 месеца считано от датата на приемателно-предавателен протокол за въвеждане на техниката в експлоатация.

2. Съгласни сме и се задължаваме да осигурим обслужване и поддръжка в рамките на гаранционния срок. За решаване на възникнали технически проблеми поемаме задължението да предоставим контакти (име, телефонен номер, факс и e-mail) на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България.

3. Съгласни сме и се задължаваме в рамките на гаранционния срок да отстраняваме всички повреди до 20 /двадесет/ работни дни от уведомяването ни.

4. Съгласни сме и се задължаваме ремонтът да се извършва с нови оригинални или нови съвместими резервни части по възможност на място в обекта на Възложителя, за което сервизният специалист изготвя протокол за извършена сервизна услуга.

5. Съгласни сме и се задължаваме в случай на използване на нови, съвместими, резервни части или подобни възли и устройства със същата функционалност, ще гарантираме, че няма да се наруши нормалната работоспособност на системата.

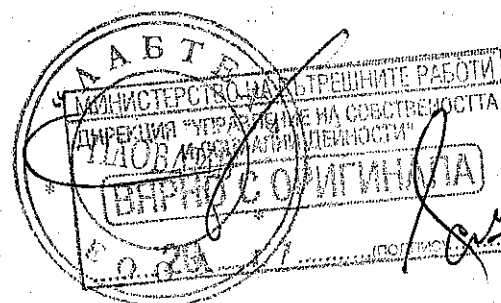

6. Съгласни сме и се задължаваме в рамките на гаранционния срок да са включени всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи, и положеният труд за ремонт на хладилната техника.

7. Предлагаме срок на изпълнение на поръчката – 90 дни.

8. Приемаме мястото за изпълнение на доставката и извършване на дейностите, свързани с нея – НИК-МВР, гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1.

IV. Прилагаме следните документи и информация, неразделна част от настоящото предложение (в случай, че участникът разполага със сервиз по точка II.6):



1. Декларация за сервиза/сервизите, който/които ще бъде/-ат използвана/-и за изпълнение на поръчката, с посочени сервиза/сервизите, неговият/техните адрес/и, телефони за връзка, факс и/или електронна поща, лица за контакт.

2. Брошура и декларация на фирмата, производител на апаратурата

Дата: 21.01.2019

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Стамен Стоянов
/Управител/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

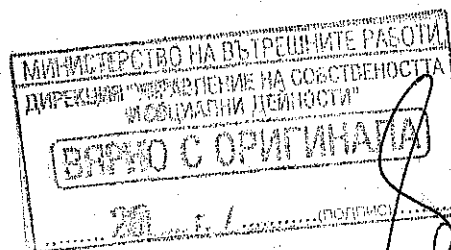

ДЕКЛАРАЦИЯ

За наличие на собствена сервизна база и технически лица, за осъществяване на профилактика, гаранционно и следгаранционно обслужване на доставената апаратура

Подписаният Стамен [REDACTED] Стоянов с лична карта № 641461890, издадена на 02.12.2010 г. от РУ на МВР Пловдив, ЕГН 6408172423, живущ в гр. Пловдив, община Пловдив, ул.Богомил № 48Б, ж.к. Централен в качеството си на Управител на участника Лабтех ЕООД

ОТНОСНО: Участие в открита процедура с с предмет:

„Доставка на лабораторна хладилна техника”

За Обособена позиция № 1 - „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер”

ДЕКЛАРИРАМ:

При изпълнението на настоящата обществена поръчка, разполагам със следната сервизна база, оторизирана от фирмите производителки, за осъществяване на гаранционно и следгаранционно поддържане на доставеното и монтирано оборудване:

Фирма Лабтех ЕООД има налична сервизна база и офис на територията на РБългария с адрес и телефони за контакт:

Адрес:

4000, гр. Пловдив, ул. “Иван Андонов” № 13

тел: 032 268627

факс: 032 242410


e-mail: labtech@mbox.contact.bg

сервизен специалист Георги Видев

Дата: 21.01.2019 г.

Деклар

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

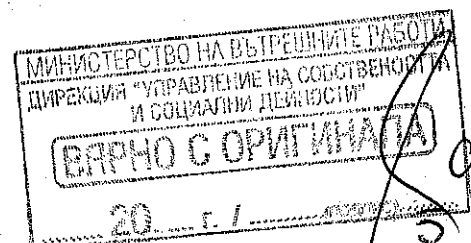

med


Ultra-low freezers

ZLN-UT

Ultra-low freezers

Application

- biotechnology
- research
- pharmacy
- storage


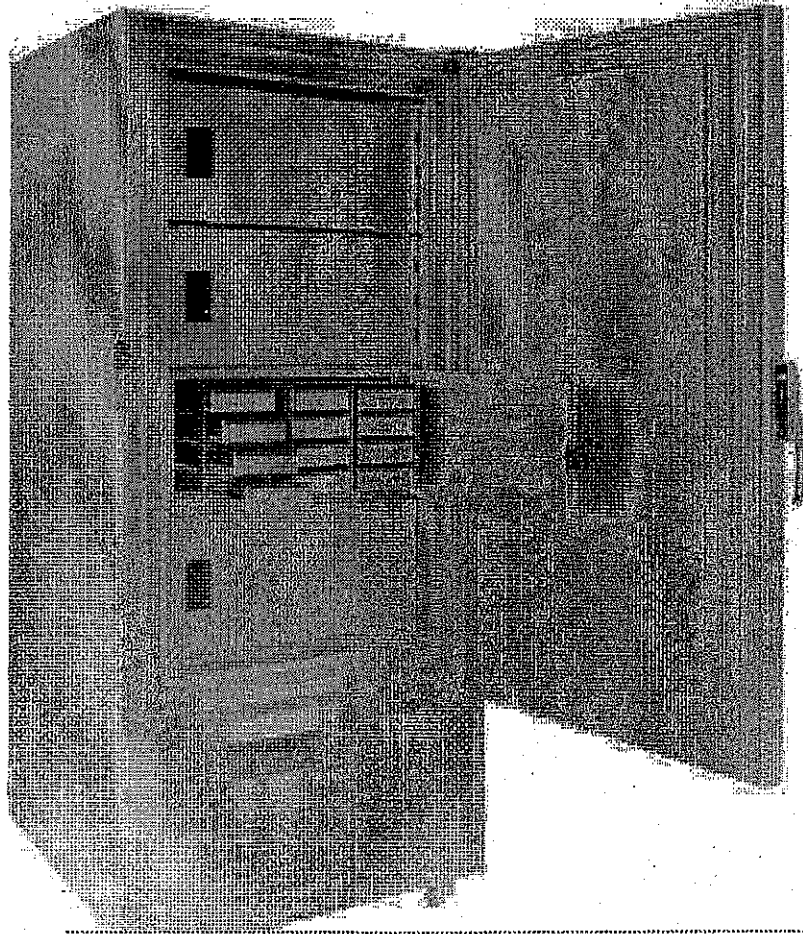


Ultra-low freezers are used for deep freezing of biotechnological samples and other materials which should be stored at very low temperature.

Calibration



All thermostatic equipment manufactured by POL-EKO-APARATURA can be provided with Calibration Certificate issued by accredited Measurement Laboratory. Detailed information on accreditation of POL-EKO Laboratorium Pomiarowe is available on website: www.polekolab.pl.

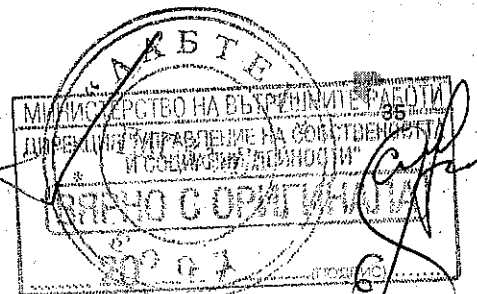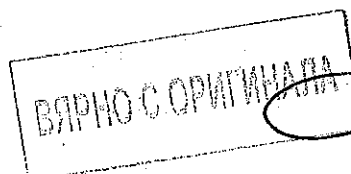

Controller advantages

- temperature range: -86...-40°C
- full stainless steel shelves with hole
- quality control protocol (at -80°C)
- English instruction manual
- available menu languages: Czech, English, Estonian, French, German, Italian, Latvian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish
- access port: Ø20 mm
- door lock
- external solid door and internal solid door for each chamber
- wheels
- controller spare batteries in case of power failure - alarm output
- additional port for installation of CO₂ & Pt100 backup

ZLN-UT 200 *New!*

ZLN-UT 300

Parameter		ZLN-UT 200	ZLN-UT 300
air convection		forced	forced
chamber capacity [l]		237	326
number of boxes 133x133x50mm [pcs]		108	144
door type		solid	solid
temperature range [°C]		-86...-40	-86...-40
temperature resolution [°C]		0.1	0.1
cooling time from +20 °C to -80 °C [h]		3.5	3.5
heating time in case of power failure -80 °C to -60 °C [h]		1.8	1.8
controller		microprocessor with external LCD graphic display	
interior	COMF	stainless steel to DIN 1.4018	
	PREM	stainless steel to DIN 1.4301	
housing		powder coated steel	
overall dims ¹ [mm]	A width	850	850
	B height	1620	1910
	C depth	650	950
	D width	520	620
internal dims [mm]	E height	830	1140
	F depth	450	650
	G height	240	240
max unit workload [kg]		65	80
max shelf workload [kg]		10	10
nominal power [W]		670	670
energy consumption 24h [kWh] at -80°C		16	16
weight [kg]		180	200
power supply*		230 V 50 Hz	
number of internal chambers		3	3
warranty		24 months	
manufacturer		POL-ECO-APARATURA	


all the above technical data refer to standard units (without optional accessories)

* - 230V 60Hz, 115V 60Hz also available

1 - depth doesn't include 50 mm of power cable

All data on temperature stability and uniformity available on www.pol-eko.eu.


Options and accessories (icon description see pages 80-81)

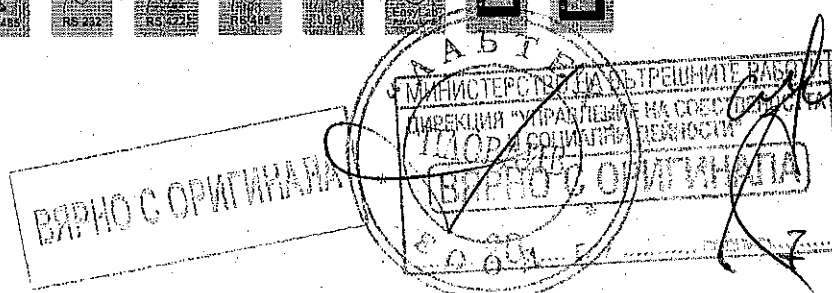


ms

5

ZLN-UT 200

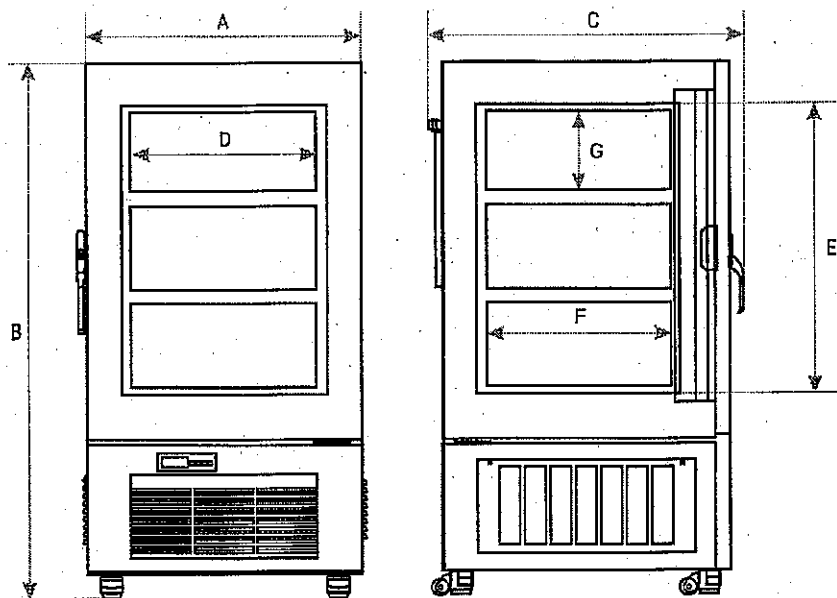


ZLN-UT 300

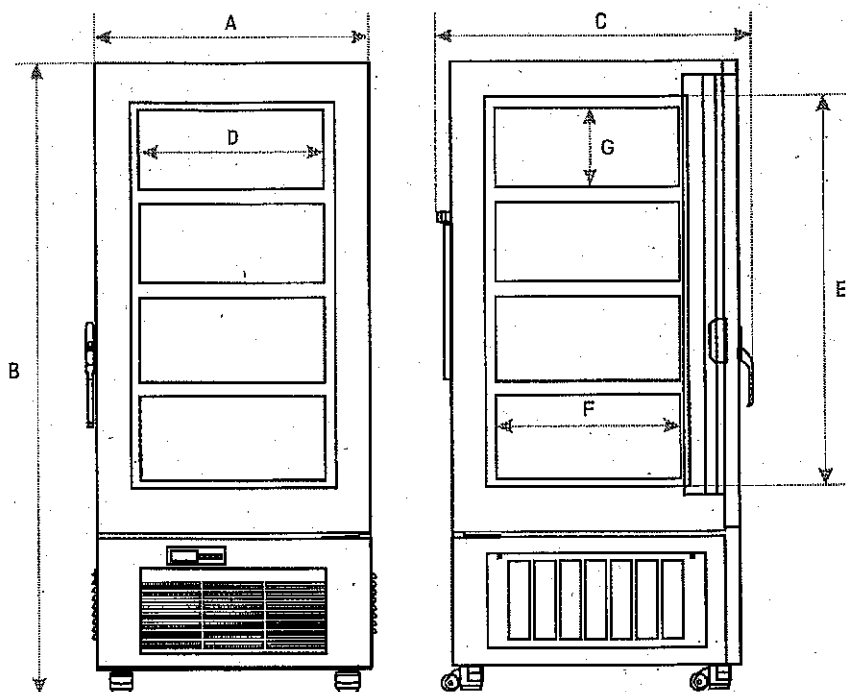

Ultra-low freezers

ZLN-UT

▲ Racks with drawers and boxes for test-tubes for ultra low freezers

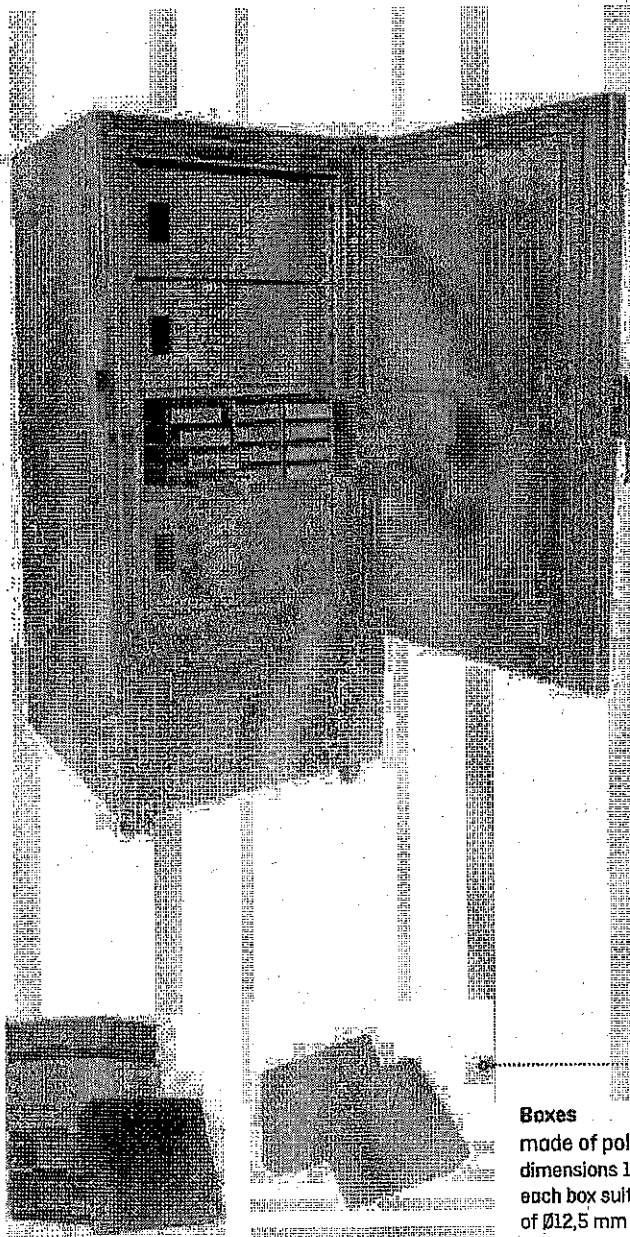


Racks with drawers
sturdy and heavy duty;
made of stainless steel;
feature quick and easy
access to all boxes;
4 drawers (each for 3 boxes)
per rack.

Boxes
made of polypropylene,
dimensions 133 x 133 x 50 mm;
each box suits 81 test-tubes
of $\varnothing 12,5$ mm

▲ Boxes for test-tubes


Model	compartments	racks per compartment	boxes per rack	boxes per compartment	boxes per unit	test-tubes per unit
ZLN-UT 200	3	3	12	36	108	8748
ZLN-UT 300	3	3	12	36	108	8748

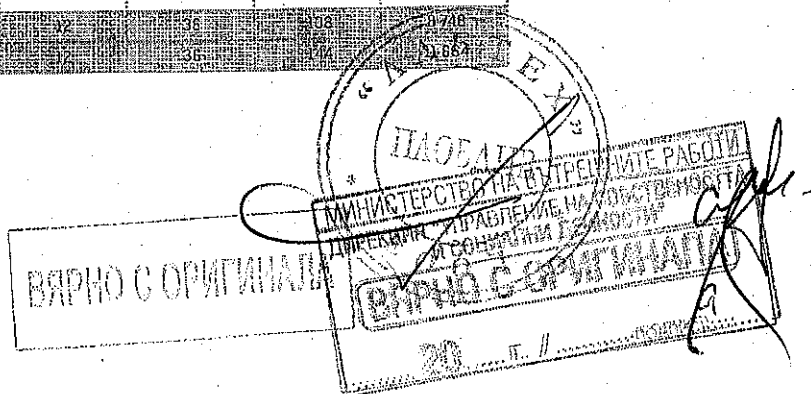


Нискотемпературни фризери

Приложение

- биотехнологии
- изследвания
- фармация
- съхранение

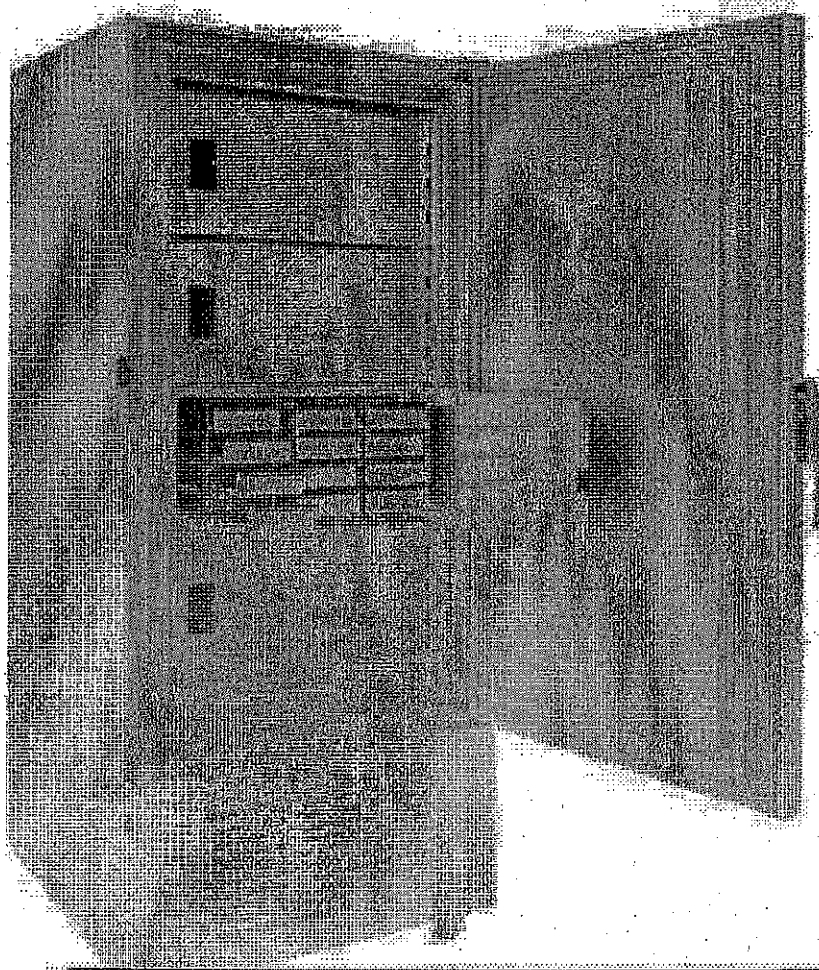

Нискотемпературните фризери се използват за дълбоко замразяване на биотехнологични проби и други материали, които трябва да се съхраняват при много ниска температура.

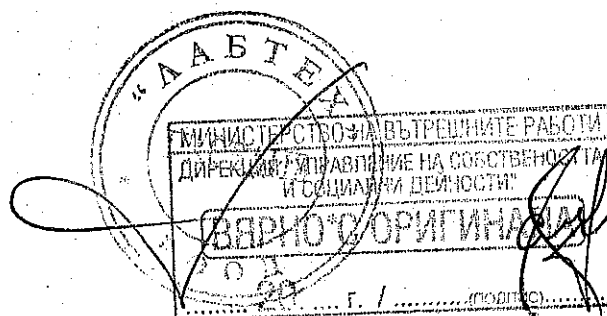

Предимства на контролера


- Температурен обхват: -86...-40°C
- Рафтове от неръждаема стомана с отвор
- Тест протокол (при -80°C)
- Ръководство за работа на английски език
- Налични езици на менюто: чешки, английски, естонски, френски, немски, италиански, латвийски, полски, португалски, руски, испански
- отвор: Ø20 mm
- заключване на вратата
- външна солидна врата и и вътрешна солидна врата за всяка камера
- -колела
- контролни резервни батерии в случай на прекъсване на захранването – алармен изход
- допълнителен порт за инсталиране на резервно копие CO₂ & Pt100

ZLN-UT
200

ZLN-UT 300

Параметър

Въздушна циркулация	Бестега	Бестега
Обем на камерата [l]	207	320
Брой кутии 133x133x50mm	108	144
Тип врата	Солдна	Солдна
Температурен обхват [°C]	-86...-40	-86...-40
Температурна разделителна способност [°C]	всички	всички
Време за охлаждане от +20 °C до -80 °C [h]	3.5	3.5
Време за нагряване в случай на прекъсване на захранването -80 °C to -60 °C [h]	1.5	1.5
контролер	Микропроцесорен с външен LCD графичен дисплей	
Вътрешно пространство	COMF	Неръждаема стомана DIN 14018
	PREM	Неръждаема стомана DIN 14301
Външен панел	Прахово покритие	
Външни размери [mm]	Аширина	850
	Височина	1910
	С дълбочина	650
	Височина	950
Вътрешни размери [mm]	Дширина	520
	Височина	1140
	С дълбочина	550
	Височина	240
Макс. натоварване на уреда [kg]	65	80
Макс. натоварване на лавица [kg]	10	10
Захранване [W]	670	670
Ел. консумация за 24h [kWh] при -80°C	18	18
Тегло [kg]	180	200
Захранване *	230 V 50 Hz	
Брой вътрешни камери	3	4
Гаранция	24 months	
Производител	POLEKO-APARATURA	

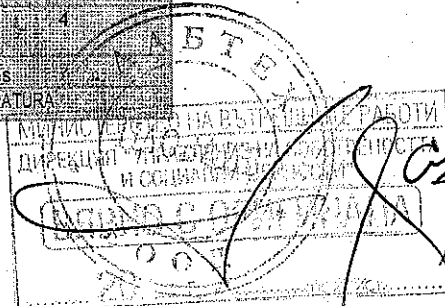

Options and accessories (icon description see pages 80-81)





36


mas

5



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

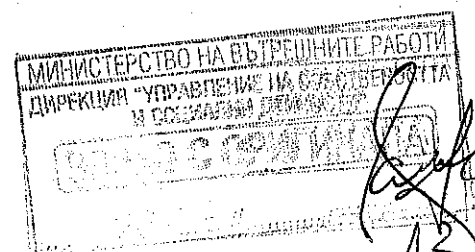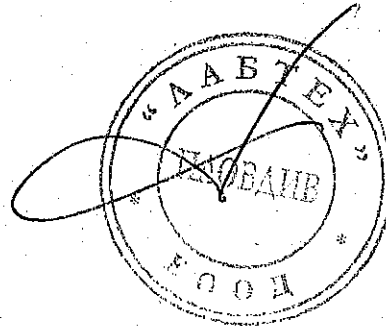

ZLN-UT 200

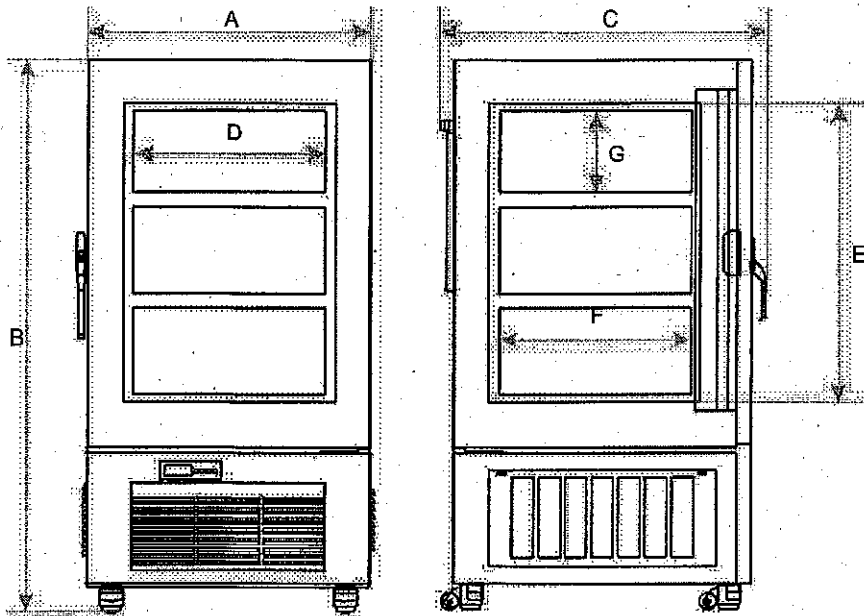


ZLN-UT 300

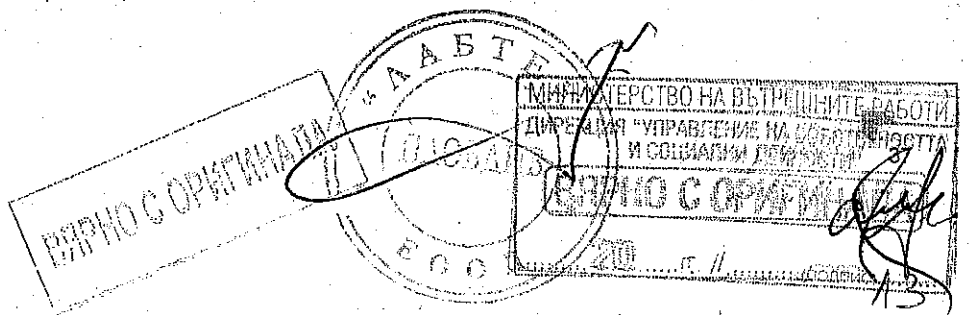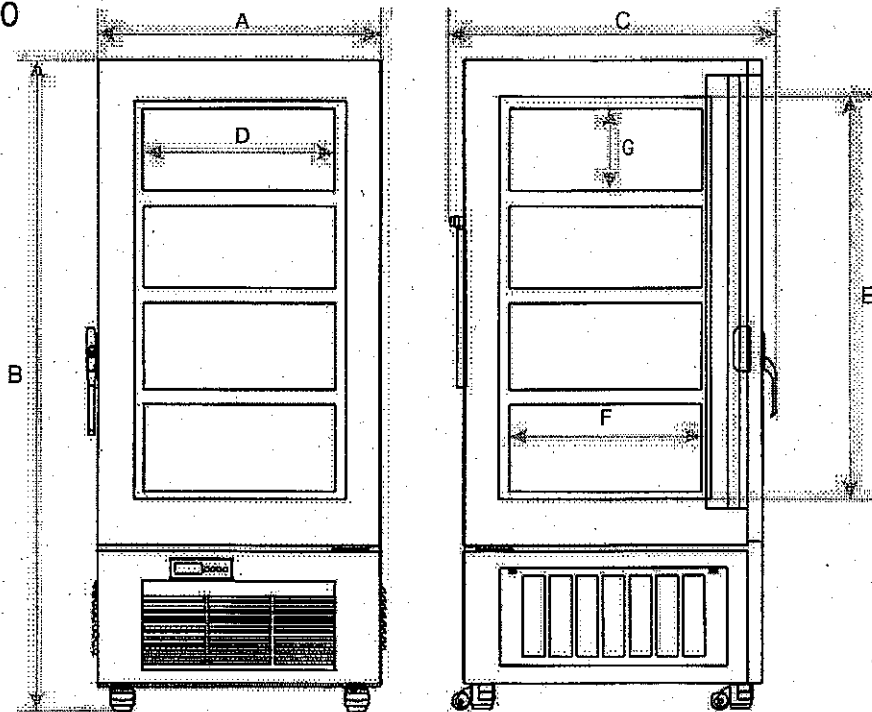

Нискотемпературни фризери ZLN-UT

■ Стелажи с чекмеджета и кутии за епруветки за нискотемпературни фризери

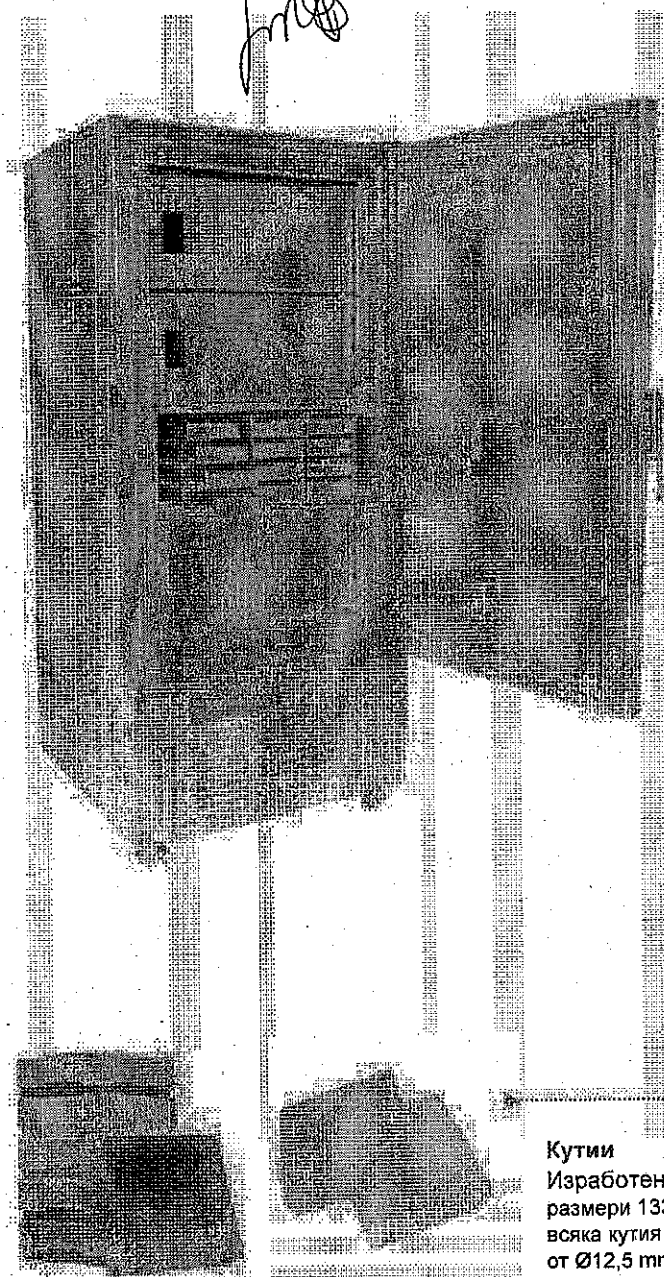

Стелажи с чекмеджета
Здрави и тежки;
Изработени от неръждаема стомана;
Бърз и лесен достъп
Достъп до всички кутии;
4 чекмеджета (всяко за по 3 кутии)
на стелаж.

Кутии
Изработени от полипропилен,
размери 133 x 133 x 50 mm;
всяка кутия побира 81 епруветки
от Ø12,5 mm

■ кутии за епруветки

Модел	Камери	Стелажи	кутии	Кутии на	Кутии на	Епруветки на
		На камера	На стелаж	камера	уред	уред
ZLN-UT 200	3	3	12	36	108	8 748
ZLN-UT 300	4	3	12	36	144	11 664





POL-EKO-APARATURA SP. J.

A. POŁOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. KOKOSZYCKA 172 C

tel. (+48) 32 453 91 70
fax (+48) 32 453 91 85

e-mail: export@pol-eko.com.pl
Internet: www.pol-eko.com.pl

Wodzisław Śląski, 17.01.2019

DECLARATION

To whom it may concern,

We, POL-EKO-APARATURA manufacturer of wide range laboratory equipment, having factories at
ul. Kokoszycka 172C, 44-300 Wodzisław Śląski, POLAND (EU), declare the following:

For CHL laboratory refrigerator:

1. The indoor temperature stability of the laboratory refrigerator is $\pm 1^{\circ}\text{C}$ at 4°C .
2. Automatic defrost (optional)
3. Type of cooling system: dynamic
4. Self-closing door (optional)
5. Possibility to change the door hanging
6. Operating ambient temperature $+10^{\circ}\text{C}$ to $+28^{\circ}\text{C}$ (optional up to 30°C)
7. The ODP (ozone depletion potential) is 0
8. The noise level is less than 50 dB
9. Alarm system at failure an open door : audible and visual

For ZLN-UT 300 COMF laboratory ultra-low freezer:


1. The ultra-low freezer ZLN-UT 300 COMF has internal battery for controller back-up and 2 compressors (cascade system).
2. Manual defrost
3. Alarm system at failure and open door : audible and visual
4. Autonomous power of the alarm system with battery
5. Operating ambient temperature $+15^{\circ}\text{C}$ to $+28^{\circ}\text{C}$
6. The ODP (ozone depletion potential) is 0
7. The noise level is less than 58 dB

POL-EKO-APARATURA sp. j.
DYREKTOR

Sebastian Kowalski


POL-EKO-APARATURA sp. j.
A. Polok-Kowalska, S. Kowalski
44-300 Wodzisław Śl., ul. Kokoszycka 172 C
tel. (32) 453 91 70
NIP 647-216-26-87

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

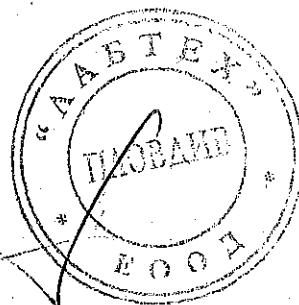

VAT ID: PL5472162687

BANK: ING BŚ o/Wodzisław Śl.
IBAN: PL 76 1050 1403 1000 0022 6920 0560
SWIFT: INGBPLPW

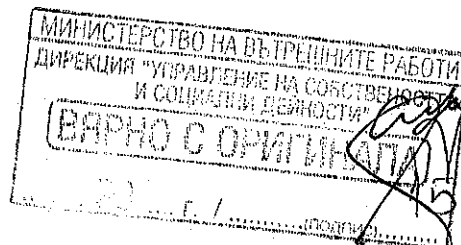

Превод от английски език

Водзислав Слашки 17.01.2019

ДЕКЛАРАЦИЯ

До: всички за които може да се отнася

Ние POL-EKO-APARATURA sp.j. , производител на голяма гама лабораторно оборудване, с производствени мощности, намиращи се на ул. Кокзитска 172 С, 44-300 Водзислав Слашки, Полша (ЕС) декларираме следното:

За лабораторни хладилници серия CHL :

1. Стабилността на температурата във вътрешното пространство на лабораторните хладилници е $\pm 1^{\circ}\text{C}$
2. Автоматично размразяване (опция)
3. Тип на охлаждащата система: динамична
4. Самозатваряща се врата (опция)
5. Сменяемо окачване на вратата.
6. Работна температура на околната среда $+ 10^{\circ}\text{C}$ до $+ 28^{\circ}\text{C}$. (опция $+ 30^{\circ}\text{C}$)
7. ODP(потенциал за разрушаване на озоновия слой) : 0
8. Нивото на шум е под 50 dB (A).
9. Алармена система при повреда и отворена врата: звукова и светлинна


Нискотемпературен фризер модел ZLN-UT 300 COMF:

1. Нискотемпературният фризер ZLN-UT 300 COMF има вътрешна батерия за автономно захранване и 2 компресора (каскадна система).
2. Ръчно размразяване
3. Алармена система при повреда и отворена врата: звукова и светлинна
4. Автономно захранване на алармената система с батерия
5. Работна температура на околната среда $+ 10^{\circ}\text{C}$ до $+ 28^{\circ}\text{C}$.
6. ODP(потенциал за разрушаване на озоновия слой) : 0
7. Нивото на шум е под 58 dB (A).

Подпис и печат:

Себастиан Ковалски

Директор

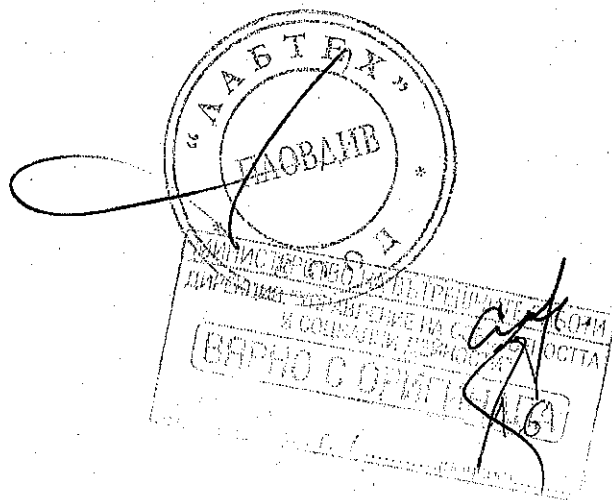

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторна хладилна техника“, обособена позиция № 2 „Доставка на нискотемпературен лабораторен фризер“

от: Лабтех ЕООД

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование	Брой	Ед. цена в лв. без ДДС	Цена общо в лв. без ДДС
1	Вертикален нискотемпературен фризер с минимален полезен обем 250 л.	1	11999.00	11999.00
Обща стойност на поръчката в лв. без ДДС				11999.00
Обща стойност на поръчката в лв. с ДДС				14398.80

Ценовото предложение включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в т.ч. мита, такси, акцизи, транспорт, доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване. В цената на гаранционното обслужване са включени цената на всички необходими резервни части, в т.ч. обявените от производителя за консумативи и положения труд за ремонт на техниката.

Дата: 21.01.2019

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД



(Стамен Стоянов)

(Управител)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка чл. 23 от ЗЗЛД

